

의료인용



# UV Activator



배앗길 水 없다!

20초로 친수성을 완성하다!

\*본 기기는 의료기기가 아님  
UV Activator는 임플란트와 같은 의료기기 등을 자외선 파장 처리하여  
친수성을 도모하는 기기입니다.  
(방송통신기자재등의 적합 인증 : R-C-DIO-UVACT02)

DIO IMPLANT



## 직관적인 UI



전원 버튼  
ON-White  
OFF-Red

시작 버튼  
작동-White  
정지-점등



도어 버튼  
열림-White  
닫힘-점등

규격  
261W X 180D X 348H  
소비전력 : Max 150W  
중량 : 6kg  
권장 UV Light 조사 시간 : 20초  
회당 사용량 : 1pcs


\* 색상(택1)



Rose Pink



Sky Blue

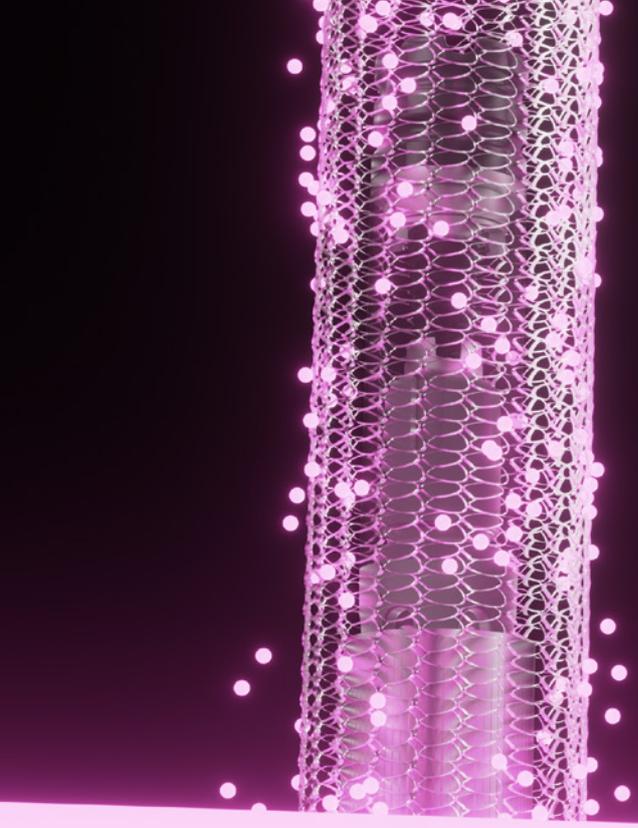

Activate in just 20 seconds with full surround UV light

## 20초의 기적

20초만에 확인할 수 있는 친수성을 경험해 보세요!

구분	습식	건식	
		UV-A 파장	DIO UV Activator
조사 방법 및 조사 시기	생산 과정에서 UV조사 후 용액에 담귀 유통	사용 전 UV조사	사용 전 UV조사
조사 시간		20시간 이상	단 20초

← 3,600배! →

## 이런 분들에게 딱이에요

고민하지 말고 선택하세요!

잇몸뼈가 약하거나  
부족한 어르신들

다수의 치아를  
상실하신 분

연세가 많으신  
어르신들

# UV로 끌어올리다!

20초 조사에 의한 표면 친수성 도포  
360° 원통형 UV Light로 빈틈없이 완벽하게!  
인체 공학적 디자인과 직관적인 UI



**DIO IMPLANT**

부산 해운대구 센텀서로 66 T. 051-745-7777 F. 051-745-7772

UV Activator2 brochure ver.1(1907)